



cryoCRYM cryoFORM cryoablation probe

cryoCRYE cryoFORM Kryoablationsonde

cryoCRYE cryoFORM cryoablationsonde

Sonda de cryoablacion cryoCRYE cryoFORM

Sonda de crioablazione cryoCRYE cryoFORM

Sonda de crioablacion cryoCRYE cryoFORM

Kryoačlační sonda cryoCRYE cryoFORM

DESCRIPTION The cryoCRYE cryoablation probe, CRYE (also referred to as PROBE) was designed for treatment of cardiac arrhythmias by achieving controlled temperature ranging from -50 °C to -70 °C.

BESCHREIBUNG Die cryoCRYE Kryoablationssonde, CRYE (auch als SONDE bezeichnet) wurde für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen durch Erzielung von kontrollierten Temperaturen zwischen -50 °C und -70 °C entwickelt.

BESCHRIJVING De cryoCRYE cryoablationsonde, CRYE (ook wel SONDE genoemd) is ontworpen voor de behandeling van hartirregulariteiten door gecontroleerde temperaturen variërend van -50 °C tot -70 °C.

DESCRIPTION The cryoCRYE cryoablation probe, CRYE (referred to as SONDA) is progettata per il trattamento delle aritmie cardiache, ottenendo una riduzione di temperature controllate che vanno da -50 °C a -70 °C.

DESCRIZIONE La sonda per crioablazione cryoCRYE CRYE (chiamata anche SONDA) è stata progettata per il trattamento delle aritmie cardiache, ottenendo una riduzione di temperature controllate che vanno da -50 °C a -70 °C.

DESCRIPCION La sonda de crioablacion cryoCRYE CRYE (también denominada sonda) e diseñada para tratar arritmias cardiacas consiguiendo temperaturas controladas que oscilan entre -50 °C y -70 °C.

POPS Kryoačlační sonda cryoCRYE CRYE (také označovaná jako SONDA) byla vyvinuta k léčbě arytmií srdce dosahováním řízených teplot v rozsahu -50 °C až -70 °C.

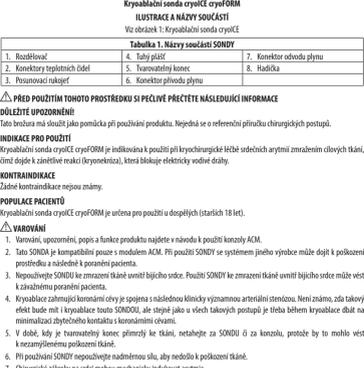
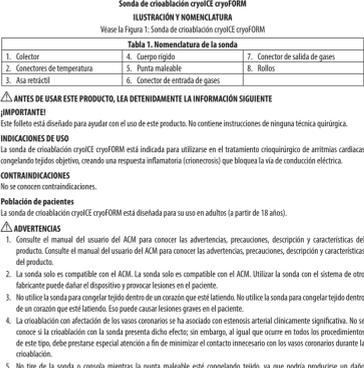
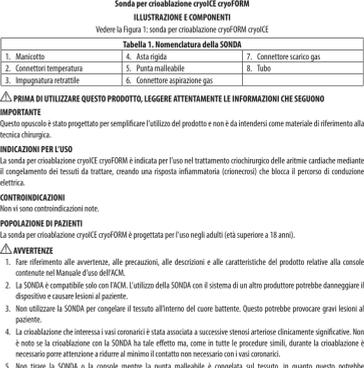
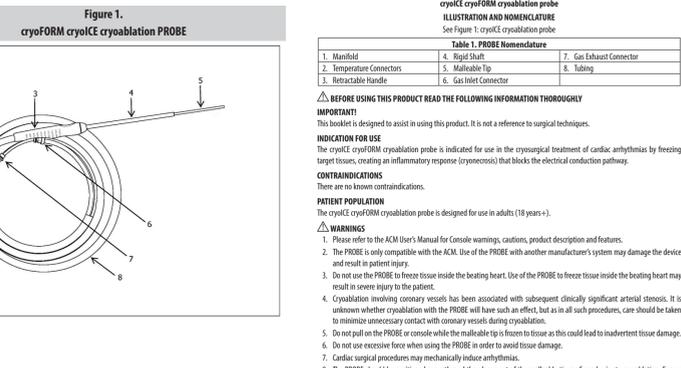


Figure 3. PROBE Connections to ACM

Table 1. PROBE Nomenclature

Table 1. Nomenclatura della SONDA

Table 1. Nomenclature della SONDA

Table 1. Nomenclature della SONDA

Table 1. Nomenclature della sonda

Tabulka 1. Nazvy součástí SONDY

BEFORE USING THIS PRODUCT READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY This booklet is designed to assist in using this product. It is not a reference for surgical techniques.

LESSE SI VOI USARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO IMPORTANTI Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'uso del prodotto e non è da intendersi come manuale di riferimento alla tecnica chirurgica.

LESSE SI VOI USARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO IMPORTANTI Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'uso del prodotto e non è da intendersi come manuale di riferimento alla tecnica chirurgica.

LESSE SI VOI USARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO IMPORTANTI Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'uso del prodotto e non è da intendersi come manuale di riferimento alla tecnica chirurgica.

LESSE SI VOI USARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO IMPORTANTI Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'uso del prodotto e non è da intendersi come manuale di riferimento alla tecnica chirurgica.

LESSE SI VOI USARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO IMPORTANTI Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'uso del prodotto e non è da intendersi come manuale di riferimento alla tecnica chirurgica.

LESSE SI VOI USARE QUESTO PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO IMPORTANTI Questo opuscolo è stato progettato per semplificare l'uso del prodotto e non è da intendersi come manuale di riferimento alla tecnica chirurgica.

CAUTIONS 1. Read all CRYE instructions as well as the ACM user manual carefully prior to using the device.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

CAUTIONS 1. Read all CRYE instructions as well as the ACM user manual carefully prior to using the device.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

AVVERTENZE 1. Leggere attentamente tutte le istruzioni di CRYE e il manuale di riferimento all'utente del modulo ACM prima di utilizzare il dispositivo.

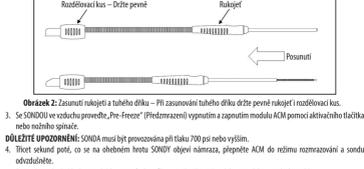
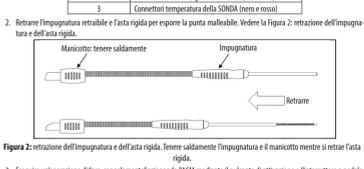
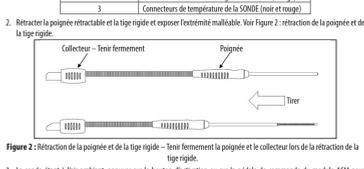
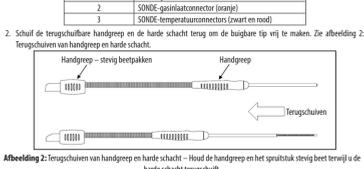
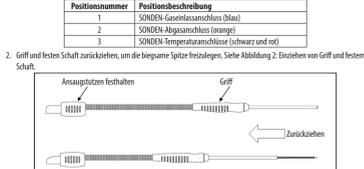
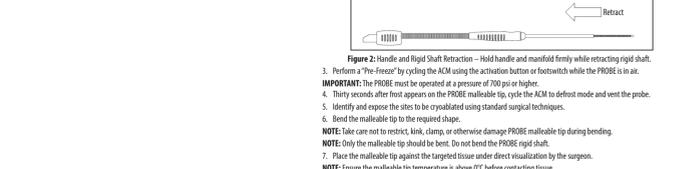


Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

Figure 2: Hand and rigid shaft extraction - Hold handles and manifold firmly while retracting rigid shaft.

CAUTION 1. Do not use excessive force when using the PROBE in order to avoid tissue damage.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

CAUTION 1. Do not use excessive force when using the PROBE in order to avoid tissue damage.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

CAUTION 1. Do not use excessive force when using the PROBE in order to avoid tissue damage.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

CAUTION 1. Do not use excessive force when using the PROBE in order to avoid tissue damage.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

AVVERTENZE 1. Non usare forza eccessiva quando si utilizza la sonda per evitare danni ai tessuti.

### Kryoablacná sonda cryoCE™ cryoFORM™

Používajte z nasledujúcimi modelmi kryoablatívnej sondy: CRYOF

**POPS**  
Kryoablačná sonda cryoCE cryoFORM. CRYOF (voľne označovaná ako SONDA) má namontovanú na konci ultrazvukovú anténu dĺžkou približne 10 cm. Pri použití sonda kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca.

Kryoablačná sonda cryoCE cryoFORM		
NÁHRAZA NÁZVU PRODUKTU		
Prílohu A1: Kryoablačná sonda cryoCE		

Tabuľka 1. Názvoslovné SONDY		
1. Rozdeľovač	4. Pevný držiak	7. Konektor výstupný plynu
2. Teplotný konvertor	5. Travníkový štítok	8. Trubica
3. Výmenný nádob	6. Konektor výstupný plynu	

### PRED POUŽITÍM SONDY PRONÁJITE DOKLADNÉ PREČITANIE NÁSLEDUJÚCEHO INFORMÁCIE

#### ČTENIE INFORMÁCIE

Tieto údaje na štítku alebo produktu sú prístupné iba odborníkom. Det je návod k chirurgickým informáciám.

#### INDIKÁCIA POUŽITIA

Kryoablačná sonda cryoCE cryoFORM je indikovaná na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda cryoCE cryoFORM je indikovaná na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda cryoCE cryoFORM je indikovaná na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

#### KONTRAINDIKÁCIE

Nie je možné štádiu kontraindikácie.

#### POPULÁCIA PACIENTOV

Kryoablačná sonda cryoCE cryoFORM je určená na použitie u dospelých vo veku 18 rokov a viac.

#### VAROVANIA

1. Pouze je povolena, upravená, pevná a vhodná konkrétna kryoablačná sonda kryoCE alebo sonda na použitie.

2. SONDA je kompatibilná iba s ACM. Použitie SONDY v systéme iného výrobcu môže poškodiť produkt a spôsobiť zranenie pacienta.

3. SONDA nepoužívajte na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca. Použitie SONDY na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca môže mať za následok zranenie pacienta.

4. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

5. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

6. Pri používaní sondy kryoCE cryoFORM nedržia nikdy, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

7. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

8. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

9. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

10. Nepokúšajte sa ohriať sondy počas používania. Náhle uvoľnenie tlaku môže spôsobiť úniky SONDY (om môže dôjsť k prerušeniu operácie alebo zraneniu).

11. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

12. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

#### POUŽITIE

1. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM je potrebné vykonať všetky kroky pre CRYOF, ako aj používať návod k použitiu ACM. Ak nebudete vedieť, ako používať sondy kryoCE cryoFORM, obráťte sa na odborníka, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

2. SONDA je kompatibilná iba s ACM. Použitie SONDY v systéme iného výrobcu môže poškodiť produkt a spôsobiť zranenie pacienta.

3. Aby sa predišlo poškodeniu tkaniva, SONDA nesmie byť namontovaná a namontovaná na použitie.

4. SONDA nepoužívajte na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca. Použitie SONDY na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca môže mať za následok zranenie pacienta.

5. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

6. Pri používaní sondy kryoCE cryoFORM nedržia nikdy, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

7. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

8. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

9. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

10. Nepokúšajte sa ohriať sondy počas používania. Náhle uvoľnenie tlaku môže spôsobiť úniky SONDY (om môže dôjsť k prerušeniu operácie alebo zraneniu).

11. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

12. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

#### NAVOJ NA POUZITIE

1. Pri použití sondy kryoCE cryoFORM je potrebné vykonať všetky kroky pre CRYOF, ako aj používať návod k použitiu ACM. Ak nebudete vedieť, ako používať sondy kryoCE cryoFORM, obráťte sa na odborníka, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

2. SONDA je kompatibilná iba s ACM. Použitie SONDY v systéme iného výrobcu môže poškodiť produkt a spôsobiť zranenie pacienta.

3. Aby sa predišlo poškodeniu tkaniva, SONDA nesmie byť namontovaná a namontovaná na použitie.

4. SONDA nepoužívajte na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca. Použitie SONDY na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca môže mať za následok zranenie pacienta.

5. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

6. Pri používaní sondy kryoCE cryoFORM nedržia nikdy, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

7. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

8. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

9. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

10. Nepokúšajte sa ohriať sondy počas používania. Náhle uvoľnenie tlaku môže spôsobiť úniky SONDY (om môže dôjsť k prerušeniu operácie alebo zraneniu).

11. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

12. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

#### OBŠAH ZISTOVANIE

1. Vyrovnajte rozloženie sondy kryoCE cryoFORM, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

2. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

3. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

4. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

5. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

6. Pri používaní sondy kryoCE cryoFORM nedržia nikdy, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

7. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

8. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

9. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

10. Nepokúšajte sa ohriať sondy počas používania. Náhle uvoľnenie tlaku môže spôsobiť úniky SONDY (om môže dôjsť k prerušeniu operácie alebo zraneniu).

11. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

12. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

#### POUŽITIE

1. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM je potrebné vykonať všetky kroky pre CRYOF, ako aj používať návod k použitiu ACM. Ak nebudete vedieť, ako používať sondy kryoCE cryoFORM, obráťte sa na odborníka, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

2. SONDA je kompatibilná iba s ACM. Použitie SONDY v systéme iného výrobcu môže poškodiť produkt a spôsobiť zranenie pacienta.

3. Aby sa predišlo poškodeniu tkaniva, SONDA nesmie byť namontovaná a namontovaná na použitie.

4. SONDA nepoužívajte na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca. Použitie SONDY na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca môže mať za následok zranenie pacienta.

5. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

6. Pri používaní sondy kryoCE cryoFORM nedržia nikdy, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

7. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

8. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

9. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

10. Nepokúšajte sa ohriať sondy počas používania. Náhle uvoľnenie tlaku môže spôsobiť úniky SONDY (om môže dôjsť k prerušeniu operácie alebo zraneniu).

11. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

12. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

#### POUŽITIE

1. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM je potrebné vykonať všetky kroky pre CRYOF, ako aj používať návod k použitiu ACM. Ak nebudete vedieť, ako používať sondy kryoCE cryoFORM, obráťte sa na odborníka, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

2. SONDA je kompatibilná iba s ACM. Použitie SONDY v systéme iného výrobcu môže poškodiť produkt a spôsobiť zranenie pacienta.

3. Aby sa predišlo poškodeniu tkaniva, SONDA nesmie byť namontovaná a namontovaná na použitie.

4. SONDA nepoužívajte na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca. Použitie SONDY na zmrázanie tkaniva vo vnútri srdca môže mať za následok zranenie pacienta.

5. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

6. Pri používaní sondy kryoCE cryoFORM nedržia nikdy, aby ste predišli poškodeniu tkaniva.

7. Operácie sú vykonávané v sterilnom prostredí. Pred použitím sondy kryoCE cryoFORM vykonajte sterilizáciu sondy kryoCE cryoFORM.

8. Pred kryoablačným použitím sondy kryoCE cryoFORM sa musí skontrolovať umiestnenie tracheálneho traktu. Počas zmrázania zariadenia, aby nedošlo k nedobroslu kontaktu tkaniva s tracheálnym traktom alebo k poškodeniu traktu, aby zabránilo nevyžadovanému zraneniu pacienta.

9. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

10. Nepokúšajte sa ohriať sondy počas používania. Náhle uvoľnenie tlaku môže spôsobiť úniky SONDY (om môže dôjsť k prerušeniu operácie alebo zraneniu).

11. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

12. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na použitie pri kryoablačnej liečbe srdcových arytmií zameraných obehových systémov.

### cryoCE™ cryoFORM™ kryoablacijsprober

Brug sammen med følgende kryoablacijsprober: CRYOF

**BEKREFTELSE**  
Kryoablační sonda cryoCE cryoFORM. CRYOF (voľne označovaná ako SONDA) má namontovanú na konci ultrazvukovú anténu dĺžkou približne 10 cm. Pri použití sonda kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca. Kryoablačná sonda kryoCE cryoFORM je určená na kryoablačnú liečbu srdca.

cryoCE cryoFORM kryoablacijsprober		
ILLUSTRATION AF NÅVNEDEL		
Se figur 1: Kryoablační sonda cryoCE		

Tabuľka 1. Terminologické údaje		
1. Manšifol	4. Šifit skaf	7. Gasuablačajonektor
2. Temperaturnakonnertor	5. Bøjlig påds	8. Slanger
3. Indtrækningshåndtag	6. Gasuablačajonektor	

#### DE FØLGENDE OPlysNINGER KONTROLLER IGTTEN, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG

#### LES DESE OPlysNINGER

Dette hæfte er beregnet som en hjælp til bedsteforstanderne ved anvendelse af produktet. Det er ikke en erstatning for kirurgiske teknikker.

#### INDIKATIONER FOR BRUG

Kryoablační sonda cryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

#### KONTRAINDIKATIONER

Der er ingen kendte kontraindikationer.

#### Patientpopulation

Kryoablační sonda cryoCE cryoFORM er beregnet til brug af voksne over 18 år.

#### ADVARSEL

1. Se Brugsanvisningen for ACM for konventionel anvendelse, friskrivningshøjde, produktbeskrivelse og funktioner.

2. SONDE er et separat komponent med ACM. Om SONDE anvendes med någon annan tillverks system kan det skada instrumentet och/eller till patienten.

3. Använd inte SONDEN för att frysa vävnad utom i hjärtat som slås. Om SONDEN används för att frysa vävnad utom i hjärtat som slås kan det orsaka skada på patienten.

4. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

5. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

6. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

7. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

8. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

9. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

10. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

11. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

12. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

#### FORSIKRETIGHEDSADVARSEL

1. Se Brugsanvisningen for ACM for konventionel anvendelse, friskrivningshøjde, produktbeskrivelse og funktioner.

2. SONDE er et separat komponent med ACM. Om SONDE anvendes med någon annan tillverks system kan det skada instrumentet och/eller till patienten.

3. Använd inte SONDEN för att frysa vävnad utom i hjärtat som slås. Om SONDEN används för att frysa vävnad utom i hjärtat som slås kan det orsaka skada på patienten.

4. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

5. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

6. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til kryoablačnej behandling af hjertarytmi ved hjælp af frysing af opbeholdningsregionen (atrium) i sinusnodal region (synusnodus), der bilerer nervestruktur for ledning af elektricitet.

7. Kryoablační sonda kryoCE cryoFORM er indikeret til

